


# Inkids 간편가이드

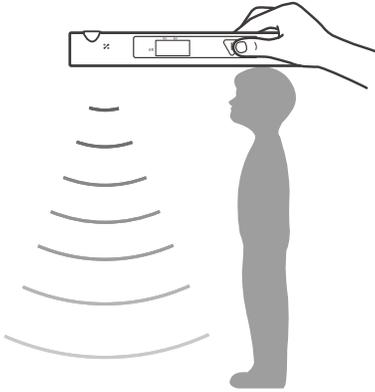

- 본 제품은 초음파를 이용해 키를 간편하게 잴 수 있는 기기입니다.
- 본 제품 사용 전에는 반드시 간편가이드를 읽어주시기 바랍니다.

## (주)인바디

고객지원: 080-578-3939 Website: <https://www.inbody.com>


## 3. Inkids 사용

- 1) 버튼을 눌러 전원을 켜세요.  
대기온도와 습도를 확인합니다.



- 2) 버튼을 한번 더 누르면 측정 화면으로 넘어갑니다. Inkids의 초음파 센서에서 발생한 신호가 바닥까지의 거리를 측정합니다. 공기를 통해 전달되는 초음파는 옆으로 퍼져 나가는 특성이 있으므로, 측정 장소 가까이 장애물 등이 없도록 주변을 잘 정돈해주세요.


※신호 전달이 방해되지 않도록 팔자세는 차렷 자세를 유지합니다.

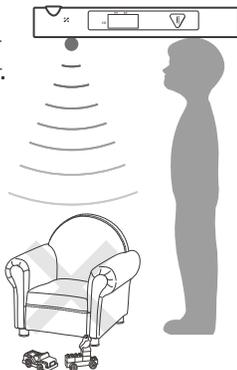

## 1. 제품 구성


Inkids의 제품 구성은 다음과 같습니다.  
각 구성품이 모두 있는지 확인하세요.

- ① Inkids
- ② 건전지 AAA Type(1.5V) × 4EA
- ③ 간편가이드

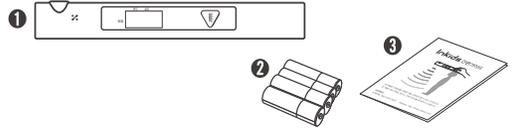


## 2. 외관 및 부분 명칭


Inkids 각 부분의 명칭은 다음과 같습니다.

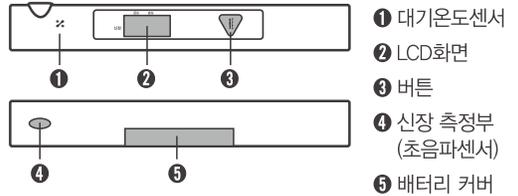

- 3) '머리 올려 놓는 위치'를 신장계 끝에 맞춰주세요. 기울어지더라도 '머리 올려 놓는 위치'를 기준으로 신장을 측정합니다. 좌우, 앞뒤 방향으로 수평을 맞추어 'PUSH'가 화면에 표시되는지 확인하세요.

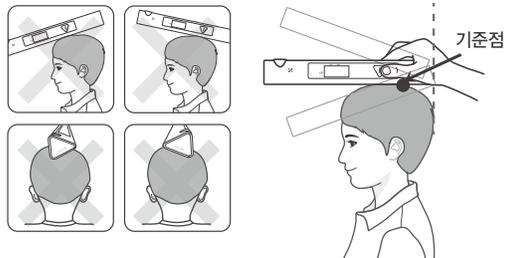

- 4) 버튼을 눌러 측정하며, 수평바가 중앙에 나타났을 때 버튼을 누르면 다시 측정할 수 있습니다.

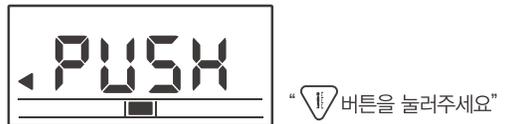

※ 3초간 버튼을 누르거나, 20초간 가만히 놓아두면 전원이 자동으로 꺼집니다

## 4. 오류 메시지

사용도중 발생하는 이상현상에 대해서 아래의 오류 메시지가 LCD화면에 나타납니다.



수평이 맞지 않습니다.

※ 오류 메시지가 나타나 후에 수평이 맞춰지면 다시 'PUSH'가 표시됩니다.



**E999**  
초음파신호가 감지되지 않습니다. 바닥에 카페트나 이불이 있지 않은지, 주변에 음파가 잘 반사되는 물체가 있지 않은지 확인하세요.



**E000**  
신장 측정부(초음파센서)가 머리카락에 가려지지 않도록 하여 측정하세요.



**E050**  
50,0cm 미만일 경우 측정이 안됩니다. 가까이에 장애물이 있는지 확인하세요.



**E200**  
200,0cm 이상일 경우 측정이 안됩니다.




**bAtt**  
배터리가 부족할 경우 화면에 배터리 아이콘이 표시되며, 측정이 불가능한 경우 'bAtt'가 표시된 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

- 떨어뜨리거나 초음파센서 쪽에 무리한 힘을 가하면 파손될 수 있으니 주의해주세요.
- 갑자기 더운 곳으로 이동하거나 에어컨 가까이에서 키를 측정하지 않도록 주의해주세요. 초음파는 대기 온도에 따라서 속도가 변하므로 대기 온도가 일정하게 유지되는 장소에서 키를 측정하세요.
- 카페트나 이불 위에서 측정하면 신호가 흡수되어 키가 정상적으로 측정되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품에 사용된 초음파센서는 약 30도 밖으로 퍼지는 성질이 있습니다. 가까이에 음파가 반사되는 물체가 있는 경우 키가 정확하게 측정되지 않습니다. 주변을 잘 정돈해주세요.
- 물이 들어가지 않도록 주의해주세요.
- 침수피해나 임의로 제품을 분해한 경우, 당사의 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다. 고객 과실로 인한 파손 및 고장은 무상 보증 서비스에서 제외됩니다.

## 7. 건전지 교체 시 주의사항

- 건전지의 +, - 극성을 확인하여 정확히 넣어 주십시오. 건전지 역 삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있습니다.




서로 다른 방향으로 삽입


- 새로운 건전지와 사용한 건전지를 함께 사용하지 마십시오. 건전지 교체 시 같은 회사, 같은 모델의 AAA사이즈 건전지 4개를 한꺼번에 교체 하십시오.
- AAA사이즈의 알카라인 건전지 또는 만간 건전지를 사용하여 주십시오.
- 젖은 손으로 건전지를 끼우지 마십시오.

## 5. 앱 다운로드 방법

InKids는 스마트폰을 이용하여 아이의 성장을 간편하게 관리할 수 있습니다. 구글 플레이스토어 또는 앱 스토어에서 '인키즈' 앱을 다운로드 받으세요.



측정 결과를 입력하세요.



신장의 변화를 한눈에 관리하세요.

\* 인키즈 앱은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 6. 사용시 주의사항

- 1) 아이들이 던지거나 떨어뜨리면 다칠 수 있으니 아이들 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 2) 장기간 사용하지 않는 경우 건전지를 빼서 보관하십시오.
- 3) 사용한 건전지는 지정된 장소에 폐기하십시오.
- 4) 잘못된 건전지 사용은 제품의 성능을 떨어뜨리거나, 제품을 손상시켜 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 8. 제품사양

기재제명칭	포터블 신장계
모델명	InLabS50
측정항목	신장, 실내온도, 습도
신장측정범위	50,0cm ~ 200,0cm
신장측정정확도	±0,5cm
기타측정범위	실내온도: 16~40℃ (±1℃) / 습도: 30~80% (±7%)
측정 시간	1초 (최대 7초)
센서	초음파센서, 온도센서, 습도센서
소비전류	100mA 이하
소비전원	DC 3V (1.5V AAA건전지 4EA)
표시화면	LCD
색상	Green, Pink, Blue, Gray
크기	43(W) × 44(L) × 300(H) : mm
무게	238g
동작환경	16 ~ 40℃, 30 ~ 80%RH
보관환경	-10 ~ 70℃

\* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



등록번호: MSIP-REM-BIB-InLabS50  
기재제명칭: 포터블 신장계  
모델명: InLabS50  
상호명: (주)인바디  
제조사/제조국: (주)인바디/대한민국